



安徽合大环境检测有限公司

181203101077

正本

检测报告

项目名称

土壤检测项目

委托单位

安徽合大环境检测有限公司

检测范围

检测项目



检测员

王亚楠

王亚楠

审核人

王亚楠

王亚楠

批准人

王亚楠

王亚楠

报告负责人

王亚楠

王亚楠

报告日期: 2018年 05月 15日



地址: 安徽省合肥市包河区包公大道100号

电话: 0551-65331077

网址: www.heda.com.cn

报告编号: HDJC-2418068-1




检测项目	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(二氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.003	mg/m ³
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³
	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³


表 2-3 检测结果

检测点位		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
检测指标	单位	2418068QT01	2418068QT02	2418068QT03	2418068QT04
总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.096	0.124	0.183	0.157
非甲烷总烃	mg/m ³	1.02	1.02	1.02	1.02

甲苯	mg/m ³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L
二甲苯	mg/m ³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L

注：若结果低于检测方法最低检出限，按照最低检出限填写。

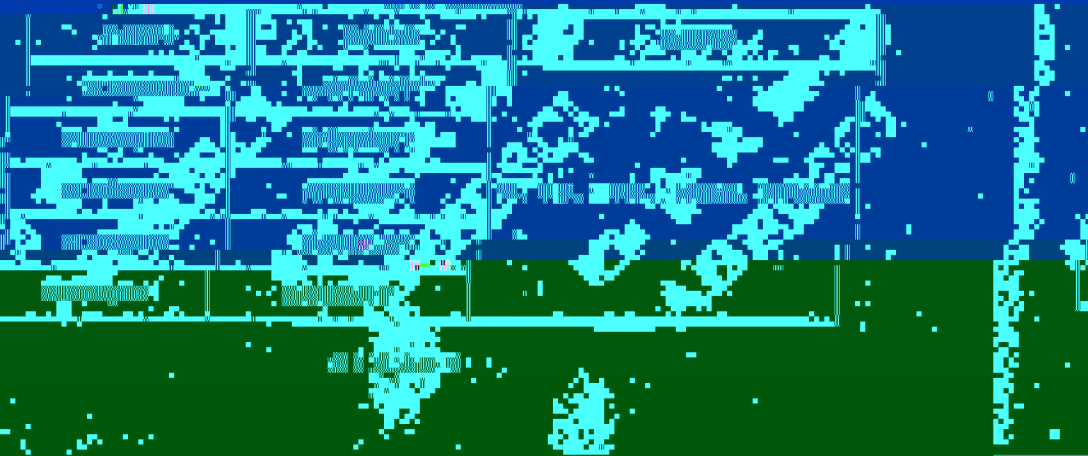

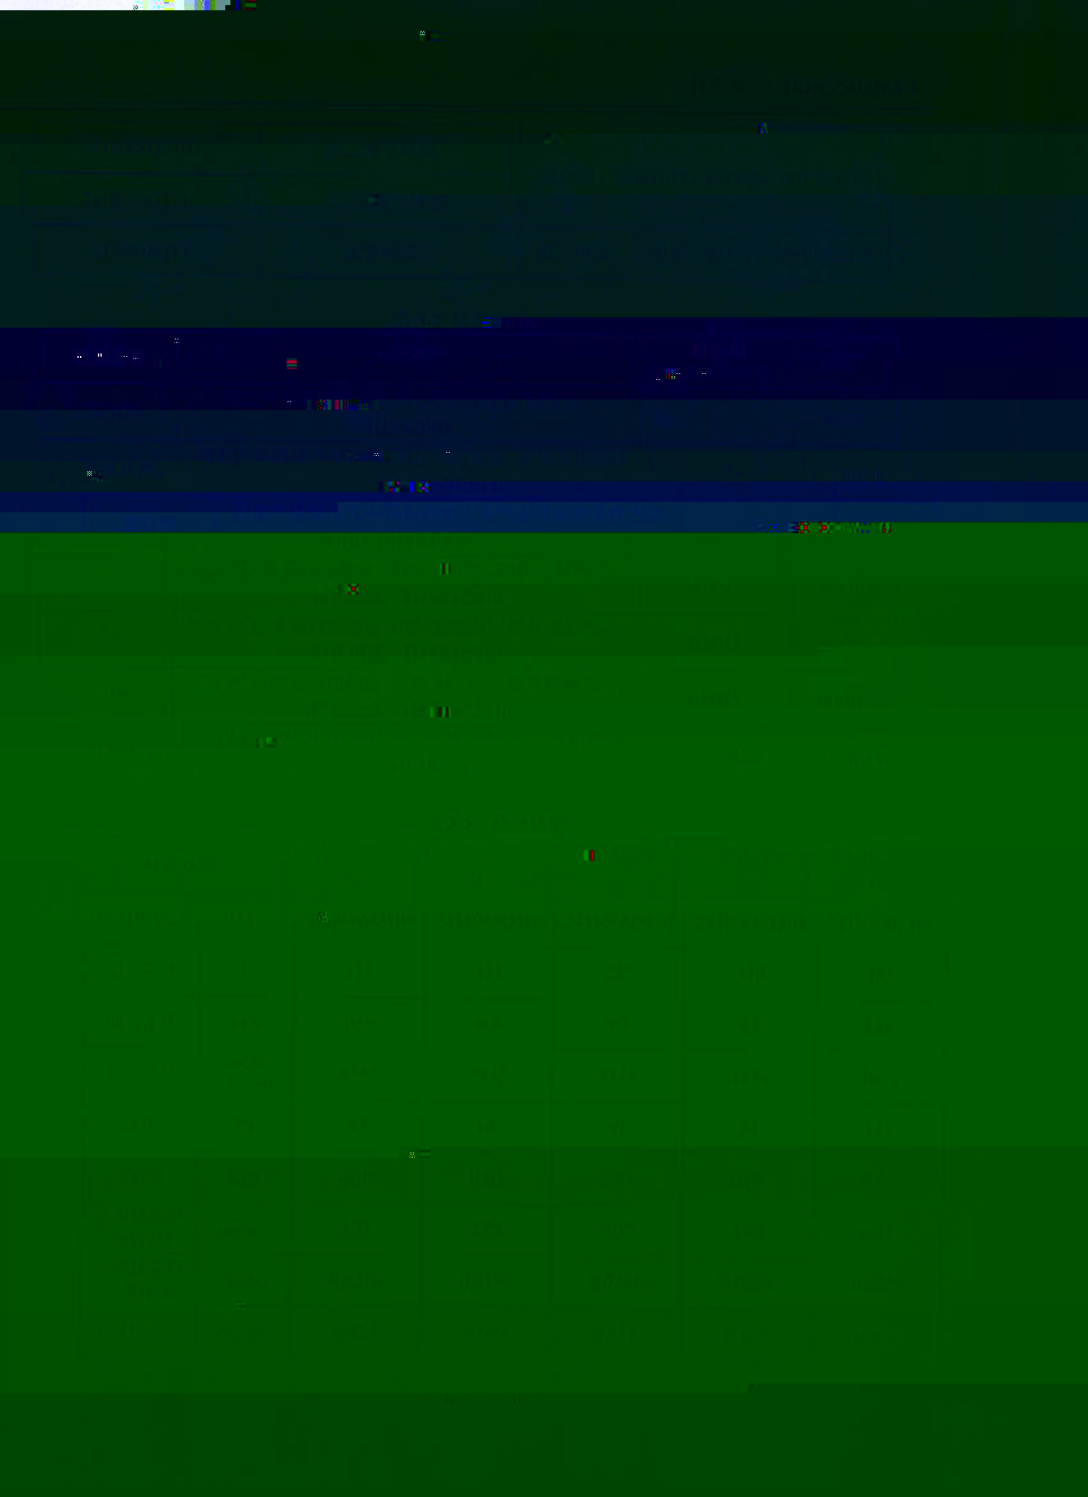

項目	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1. 売上高	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
2. 売上高の増減	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111
3. 売上高の構成	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
4. 売上高の地域別	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
5. 売上高の業種別	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
6. 売上高の国別	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
7. 売上高の顧客別	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
8. 売上高の製品別	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
9. 売上高のサービス別	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901
10. 売上高のその他	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123	789,012	678,901

二甲苯排放速率	kg/h	0.1316	0.0721	2.312
---------	------	--------	--------	-------

二甲苯排放速率	kg/h	--	--	0.0141
二甲苯实测浓度	mg/m ³	--	--	0.043
二甲苯排放速率	kg/h	--	--	0.0175

注:若结果低于检测方法最低检出限,填写最低检出限并加L。

四、噪声检测

检测日期: 2018年8月27日

检测人员: 吴磊、张天赐

表 4-1 检测点位

检测点位	检测点布置	主要声源	噪声类型
▲1	厂界北	/	厂界噪声
▲2	厂界东	/	
▲3	厂界南	/	
▲4	厂界西	/	

8月27日	
单位: dB(A)	
	昼间
▲1	59.3
▲2	59.7
▲3	55.4
▲4	53.9
	夜间
	49.5
	49.7
	47.5
	45.8

五、检测气象条件

检测日期	天气状况	风向	风速	气温	气压
8月27日	晴	东北风	1.7 m/s	34 ℃	100.1 kPa

六、样品信息

平行样名称	平行样编号	样品浓度 (mg/L)	平均值 (mg/L)	相对平均偏差 (%)	是否合格
	2418068SZ001				

七、主要检测设备

仪器编号	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号
YQ-SY-1-2#	PH计	PHS-3C	0.1-14.0	±0.1	2019/6/24	H1180625006003
YQ-SY-2-2#	紫外可见分光光度计	UVmini-1240	200-1000nm	±2nm	2019/3/5	H1180306002004
YQ-SY-4-1#	原子吸收光谱仪	--	184-900nm	0.5nm	2019/8/13	YH2017-1-580330、YH2017-1-580329
YQ-SY-2-3#	恒温箱	FUL19790	8-350℃	±0.1%℃	2019/6/5	YH2017-1-580233

YQ-SY-7-3#	气相色谱仪	GC-201423	±1%(K ₂)	8/13	FID、 FPD2019/ ECD:2020 /7/19	FID:YH2017-1-5803 31、 FPD:YH2017-1-580 413、 ECD:H18072000200
------------	-------	-----------	----------------------	------	---------------------------------------	--

八、数据结论



(以下为客户)